


Акустический комплекс звукового давления Ак -140

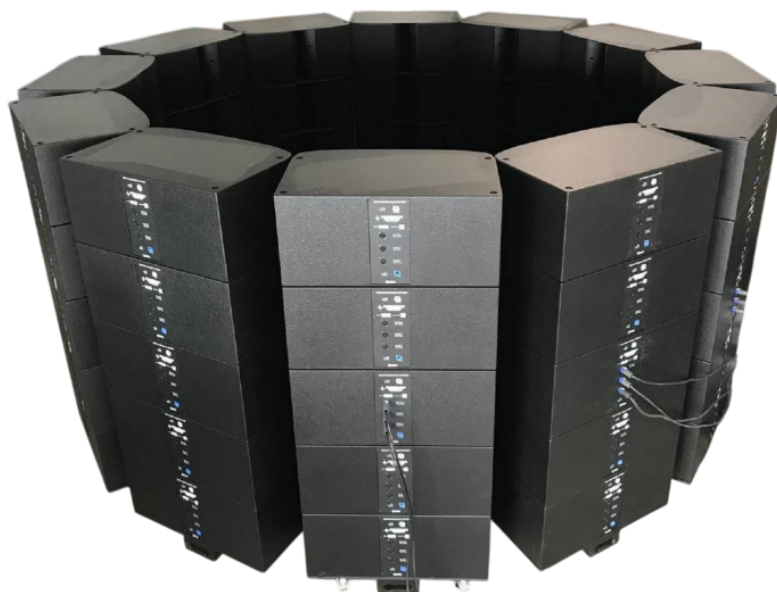

Основные характеристики:

Диапазон частот:	50 Гц – 10 кГц Опционально: 31 Гц – 20 кГц
Звуковое давление:	До 140 дБ (СКЗ)
Макс. габариты объекта испытаний:	700 х 700 х 700 мм Опционально: 3000 х 7000 мм
Формы сигналов:	Белый/розовый шум, синус, тон меняющейся частоты, пользовательский сигнал
Длительность испытания:	До 8 часов
Соответствие стандартам:	ГОСТ РВ 20.57.305 – 98

Состав комплекса:

- Акустическая система с НЧ и СЧ-излучателями
- Возможность менять размеры испытания
- Стойка с усилителями мощности с DSP-процессором
- Российское программное обеспечение
- Шумомер-анализатор спектра, $\frac{1}{2}$ микрофоны свободного поля


Типы испытаний:

- Акустическая прочность СВЧ аппаратуры космической и авиационной техники к воздействию широкополосного акустического шума и тона меняющейся частоты в соответствии с ГОСТ РВ 20.57.305 – 98.
- Артикуляционные испытания средств связи на соответствие ГОСТ Р 50840-95.

Возможности программного обеспечения комплексов:

Акустические комплексы позволяют воспроизводить различные типы сигналов: широкополосный белый и розовый шум, синус, тон меняющейся частоты.


Также возможно воспроизведение пользовательского сигнала, который можно экспортировать в содержащуюся в программном обеспечении встроенную библиотеку аудио-файлов.

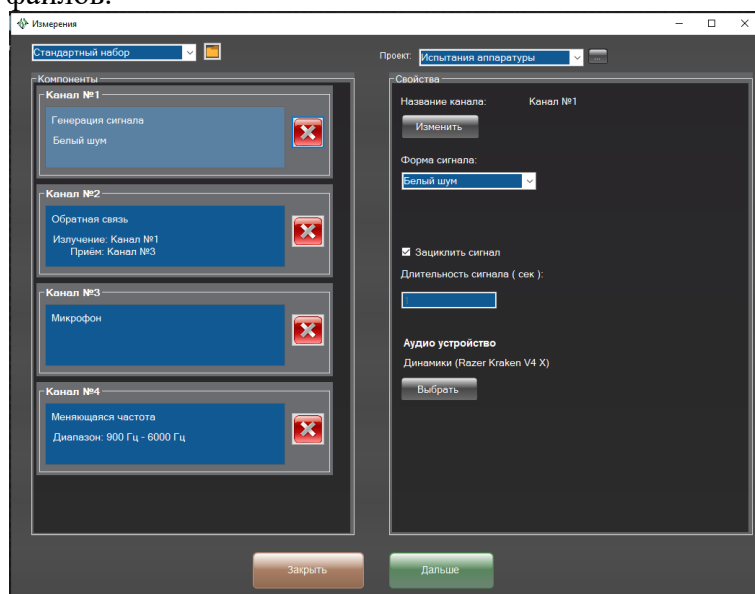

Артикуляционные испытания

Для проверки разборчивости речи по ГОСТ 50840-95 программное обеспечение акустических комплексов оснащено полным набором артикуляционных таблиц фраз и слогов для их воспроизведения машинной речью, которая имитирует диктора.

Встроенная в программное обеспечение нейронная сеть позволяет в автоматическом режиме распознавать слова по технологии машинного слуха.

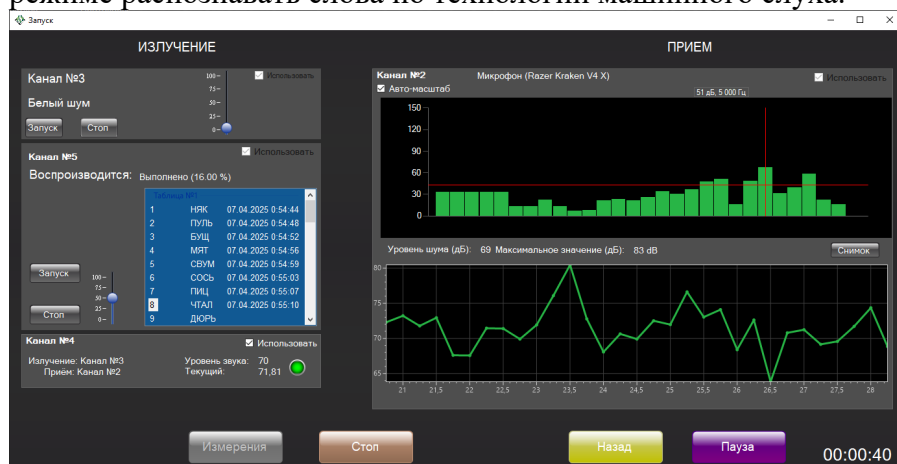

Обратная связь

Режим обратной связи позволяет пользователю установить требуемый уровень звукового давления и программное обеспечение с помощью данных с шумомера автоматически регулирует звуковую мощность с излучателей, повышая либо понижая её до установленного пользователем значения.

Дискретные частоты

В случае если измерения нужно проводить в определенных дискретных частотных точках, то пользователь указывает требуемые ему частоты 1/3 или 1/12 октавного диапазона и уровень мощности на данных точках.

Генерация сигнала и измерение АЧХ на выбранных точках происходит автоматически.



Сравнение АЧХ

Модуль программного обеспечения акустических комплексов позволяет с помощью подключаемых измерительных приборов (шумомер, анализатор спектра) сравнивать АЧХ наблюдаемых сигналов с библиотекой сигналов для их автоматического распознавания.